




2019年度 QFT – Plusチェックシート 評価まとめ


2020年10月31日
結核感染診断研究会(Web)

国立病院機構埼玉病院
岩崎 康治

QFT – Plus採血管の採血前保管温度

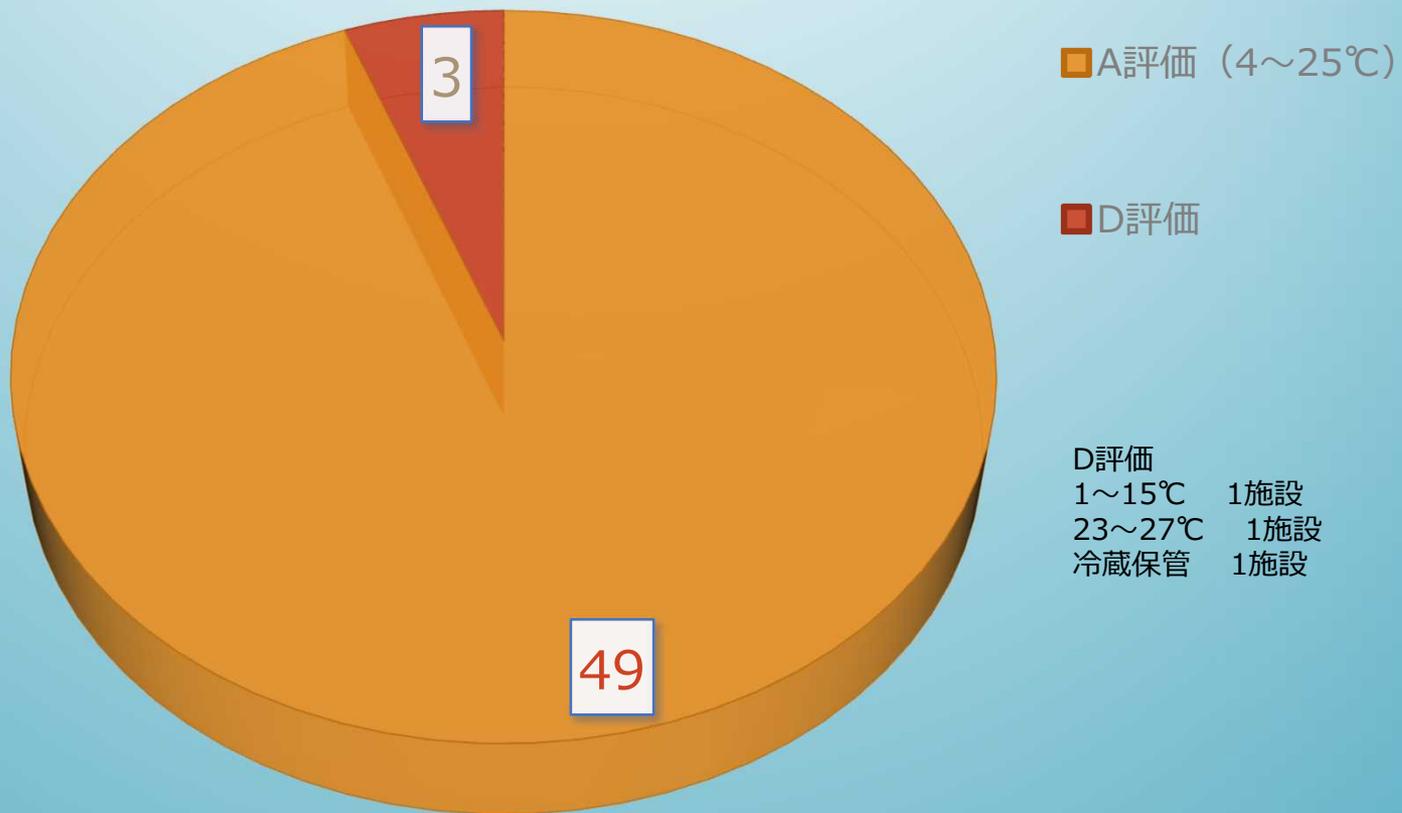


1本採血採用施設での分注までの時間

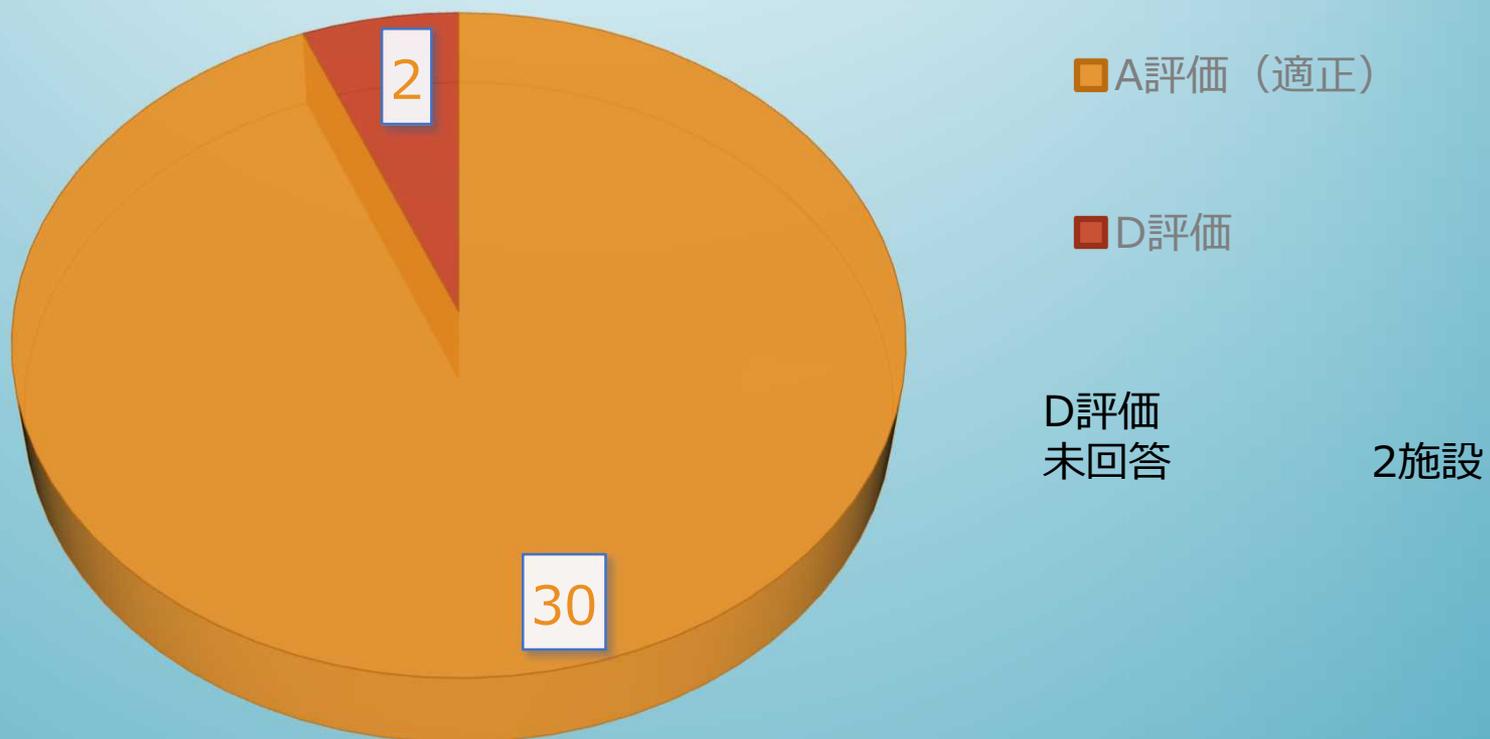


採血条件の周知

採血前採血管の保管条件・採血時の温度：室温・採血管を室温に戻している・採血量の厳守・採血の順番・採血後の混和法・採血後の保存温度の厳守・採血時間依頼書等への記載

2019年度

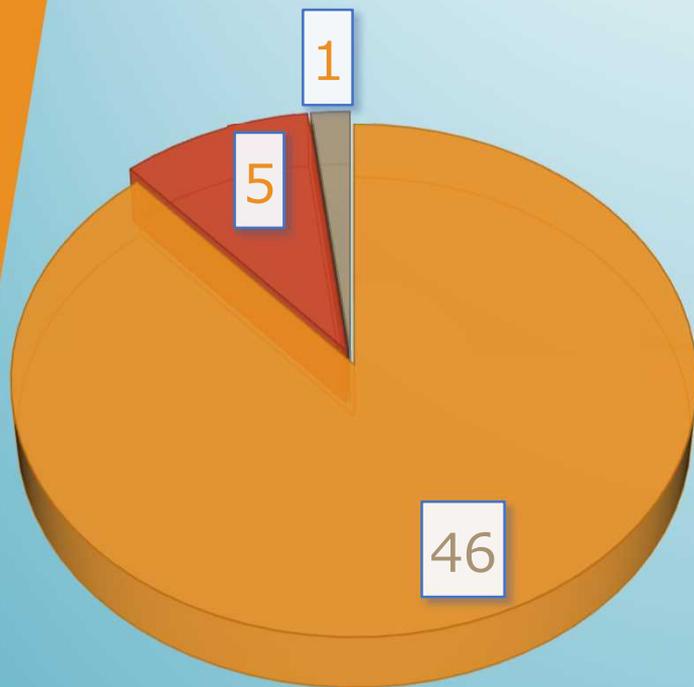


2018年度

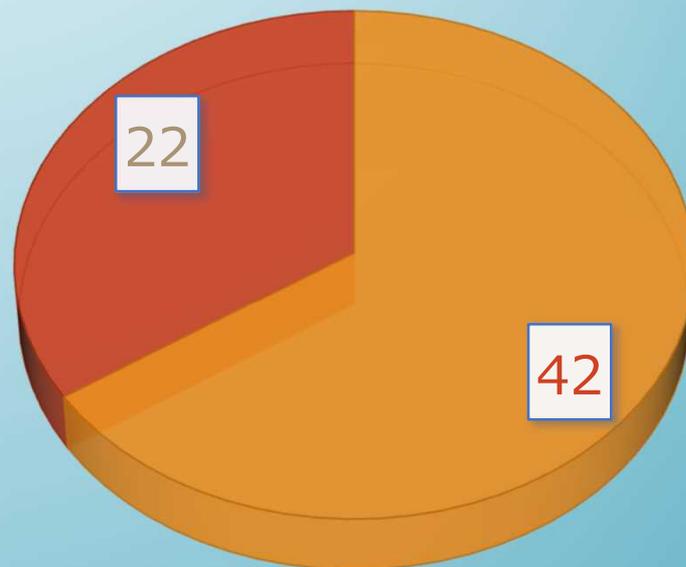

- A評価 (YES)
- D評価 (NO)
- 評価対象外

受託施設に培養・遠心条件を指示しているか

2019年度

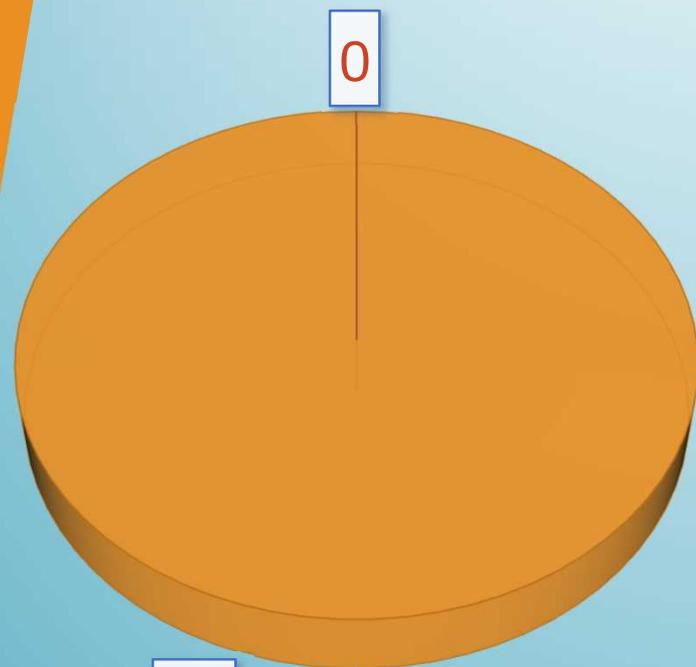

2018年度




■ A評価 (適正)


■ D評価

自施設で検査している場合に培養・遠心条件を遵守しているか

2019年度

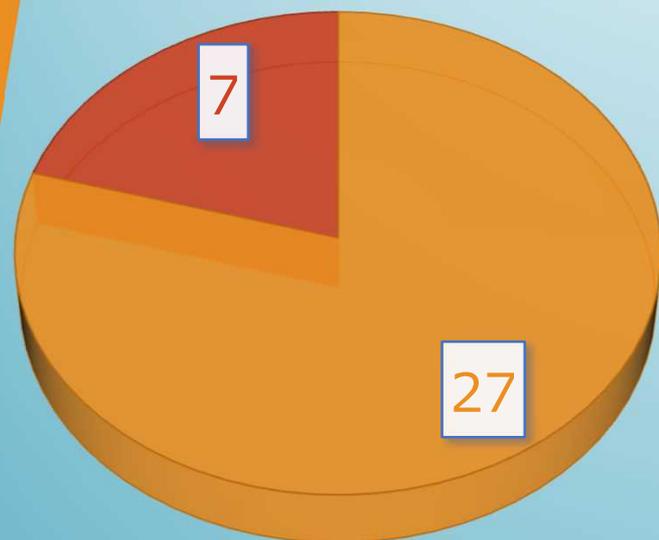


2018年度

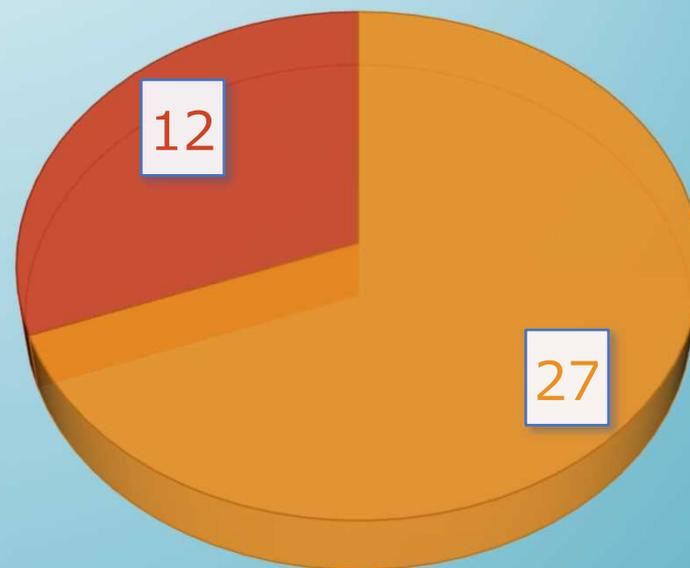

■ A評価 (適正)


■ D評価

採血時のホルダーを使用した直接採血の注意喚起をしているか

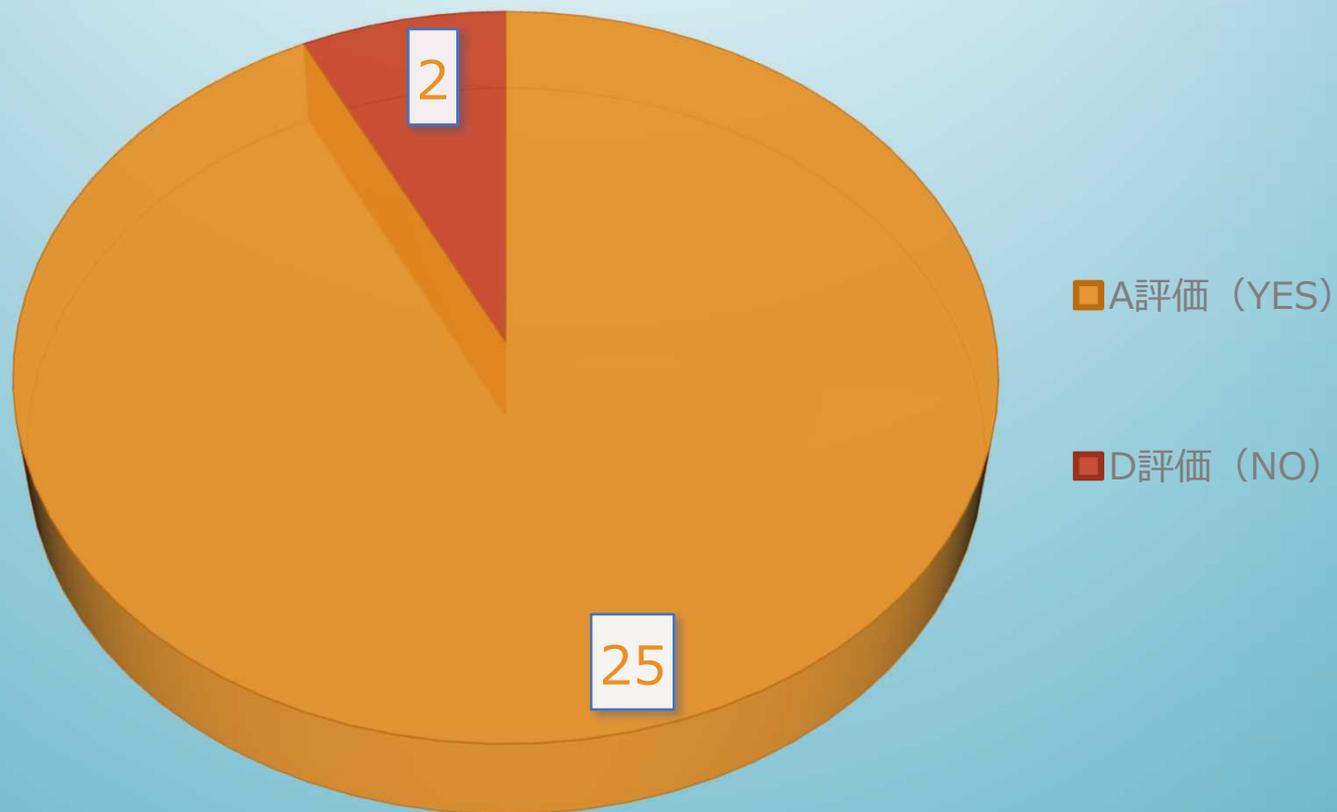


標準作業手順書（SOP）の作成について

2019年度

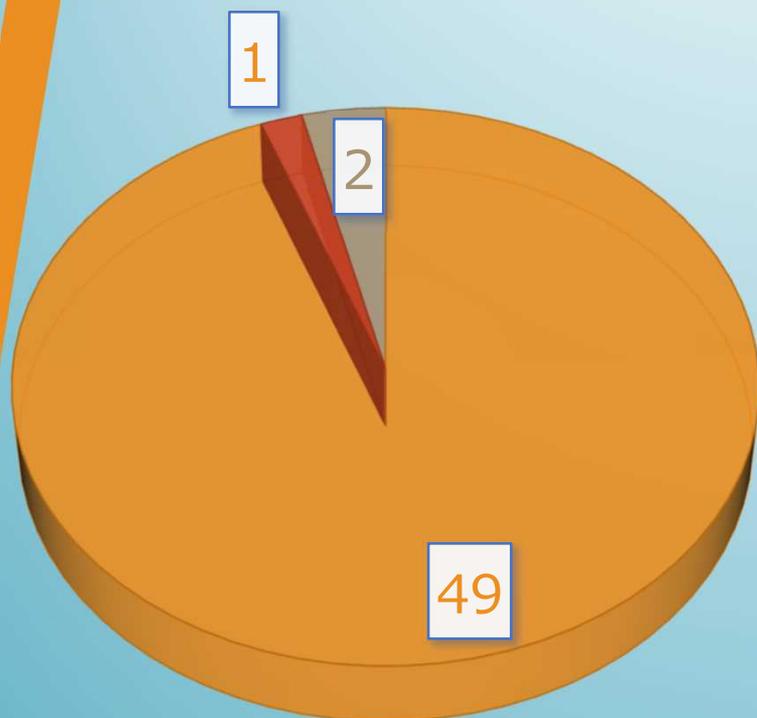


2018年度

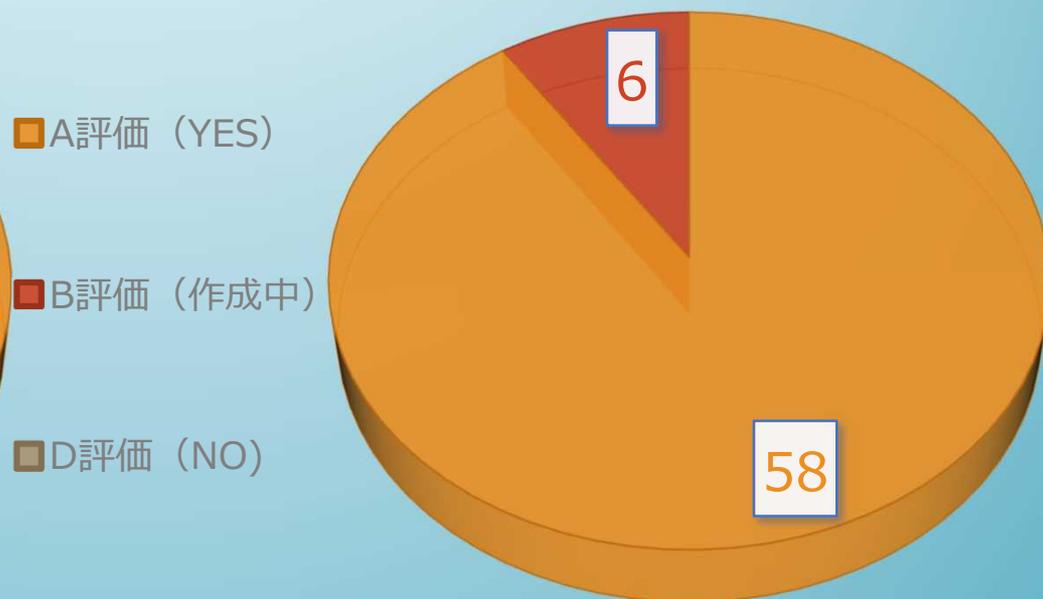

- A評価 (YES)
- B評価 (作成中)
- D評価 (NO)

測定波長

2019年度

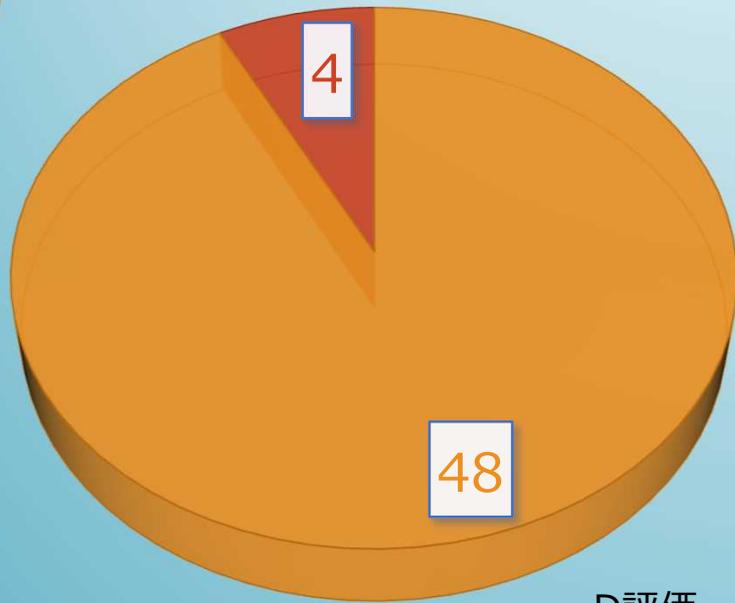

2018年度




■ A評価

■ D評価

D評価
対照波長を確認していない


反応停止から測定までの時間

2019年度

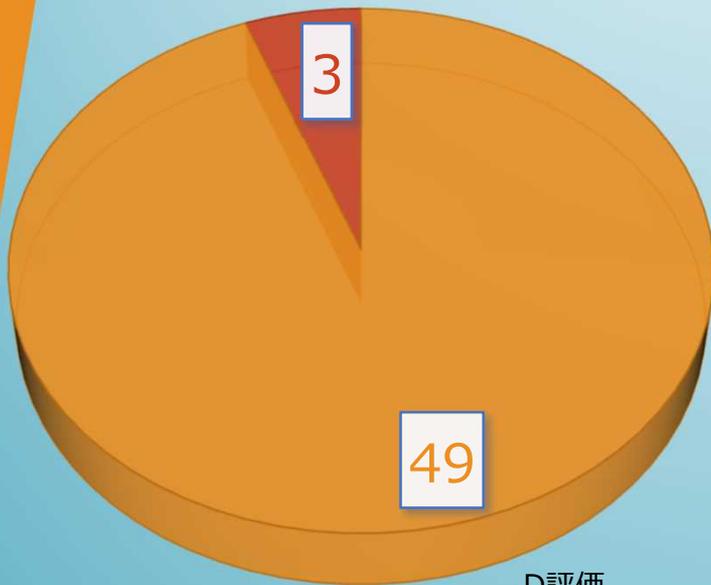

D評価
10分 1施設
不明 1施設
未回答 1施設

2018年度

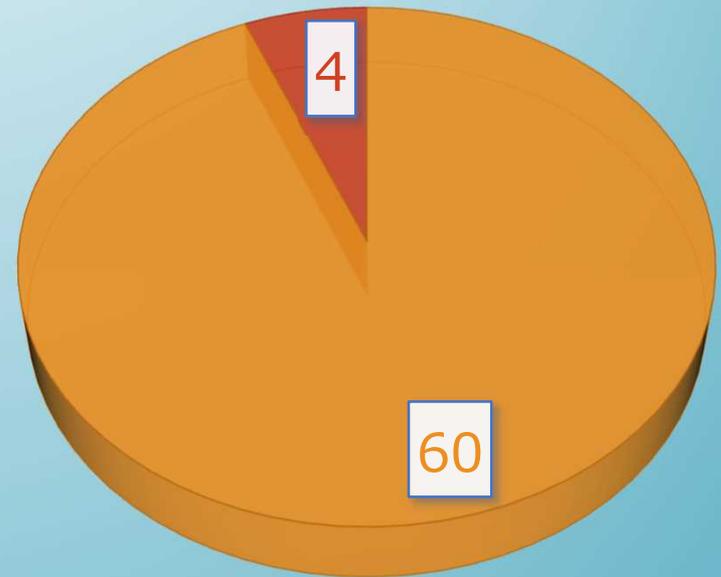


■ A評価
■ D評価

洗浄回数

2019年度



2018年度

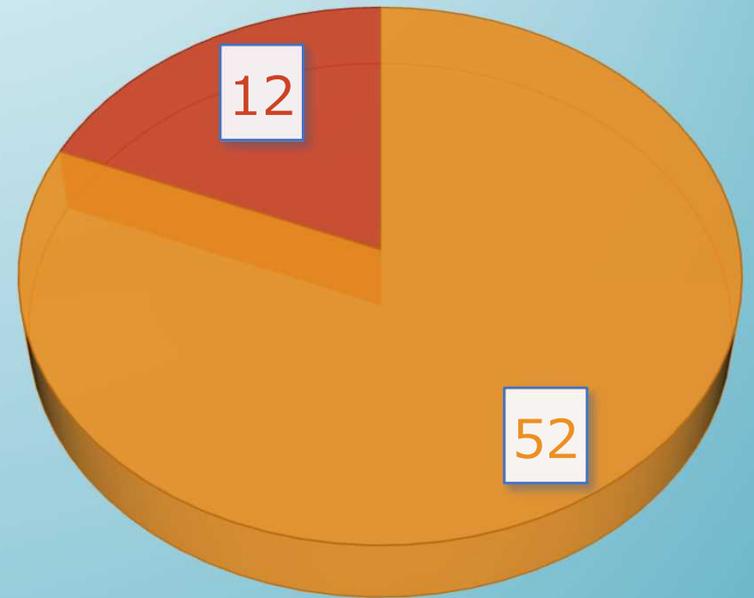

■ A評価

■ D評価

D評価
未回答 1施設